

SỞ Y TẾ NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 651 /BVĐK-VTTBYT

V/v mời cung cấp thông tin
kỹ thuật, báo giá máy đo độ loãng
xương (Máy đo mật độ xương)

Ninh Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Các công ty, đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang có nhu cầu mua sắm máy đo độ loãng xương (đo mật độ xương), cụ thể như sau:

Stt	Tên tài sản	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản
1	Máy đo độ loãng xương (Máy đo mật độ xương)	01	Cái	<p>1. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none">- Tình trạng mới 100%, sản xuất từ năm 2022 trở về sau- Thiết bị đồng bộ- Nhà sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn ISO 13485- Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa đến ≥ 30 độ C, độ ẩm tối đa đến $\geq 60\%$- Thiết bị tương thích nguồn điện: 220V/50Hz $\pm 10\%$ <p>2. Yêu cầu cấu hình</p> <p>2.1. Thiết bị chính:</p> <ul style="list-style-type: none">- Máy chính (đã bao gồm khối phát tia X, detector và bàn bệnh nhân): 01 cái- Khối điều khiển, tái tạo (tích hợp hoặc độc lập: bộ máy vi tính kèm phần mềm, cáp truyền dữ liệu): 01 bộ- Phantom chuẩn máy: 01 bộ- Phần mềm phân tích và chẩn đoán: 01 bộ- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ- Đĩa/ USB cài đặt phần mềm: 01 bộ <p>2.2. Trang thiết bị phụ trợ:</p> <ul style="list-style-type: none">- Máy in màu: 01 cái- Bộ lưu điện (UPS) cho máy vi tính: 01 bộ <p>3. Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản</p> <ul style="list-style-type: none">- Sử dụng để đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA (phương pháp hấp thu tia X năng lượng kép (Dual Energy X-ray Absorptiometry)).- Có chức năng đo/ quét toàn thân; xương cột sống thẳng, nghiêng; xương đùi; xương cẳng tay.- Có bộ hỗ trợ định vị bệnh nhân, công tắc dừng khẩn cấp, điều khiển di chuyển để chụp các vị trí khác nhau.- Có khả năng kết nối với hệ thống thông tin bệnh viện.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình kính mời các công ty, đơn vị có đủ khả năng, năng lực cung cấp thông tin kỹ thuật, báo giá cho tất cả hàng hóa nêu trên.

Yêu cầu hồ sơ bao gồm: Catalog, bản thông số kỹ thuật với đầy đủ nội dung: tên chung, tên thương mại; hãng, nước, năm sản xuất; hãng, nước chủ sở hữu; tiêu chuẩn chất lượng, môi trường hoạt động; cấu hình; tính năng, công nghệ, thông số kỹ thuật chi tiết; khả năng kết nối với hệ thống thông tin y tế, nâng cấp, cập nhật phần mềm; các điều khoản thương mại, bảo hành, ...

- **Thời gian nhận tài liệu:** trong vòng 14 ngày kể từ ngày Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện.

- **Nơi nhận tài liệu:** Bộ phận Văn thư - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 02293 871 030.


(bản scan gửi qua email: vattudknb@gmail.com)

Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện và gửi cho các đơn vị có khả năng thực hiện hoặc có yêu cầu./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo BV;
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, VT-TBYT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

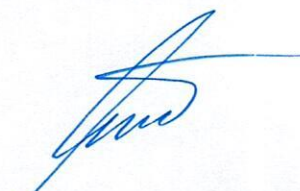

Nguyễn Văn Tuyên